StecoGuide

Bohrhülsen

in coDiagnostiX™

dental wings

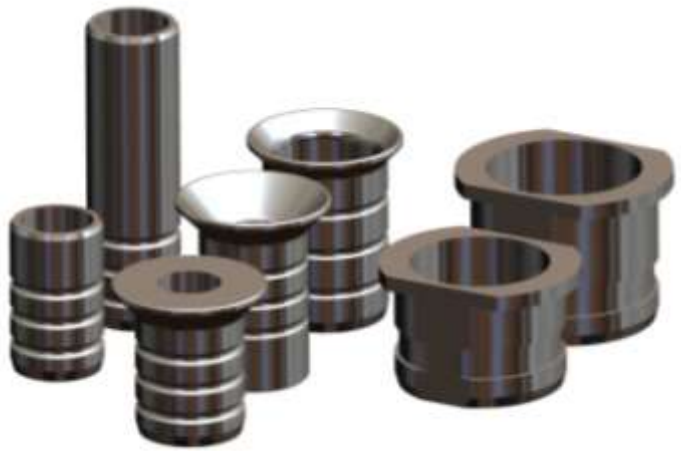

StecoGuide

Universelle Bohrhülsen

- Titanhülsen für Implantatplanung
- Universalhülsen für Implantatchirurgie
- Alternative Führungshülsen für Guided Surgery

Welche Hülse wofür?

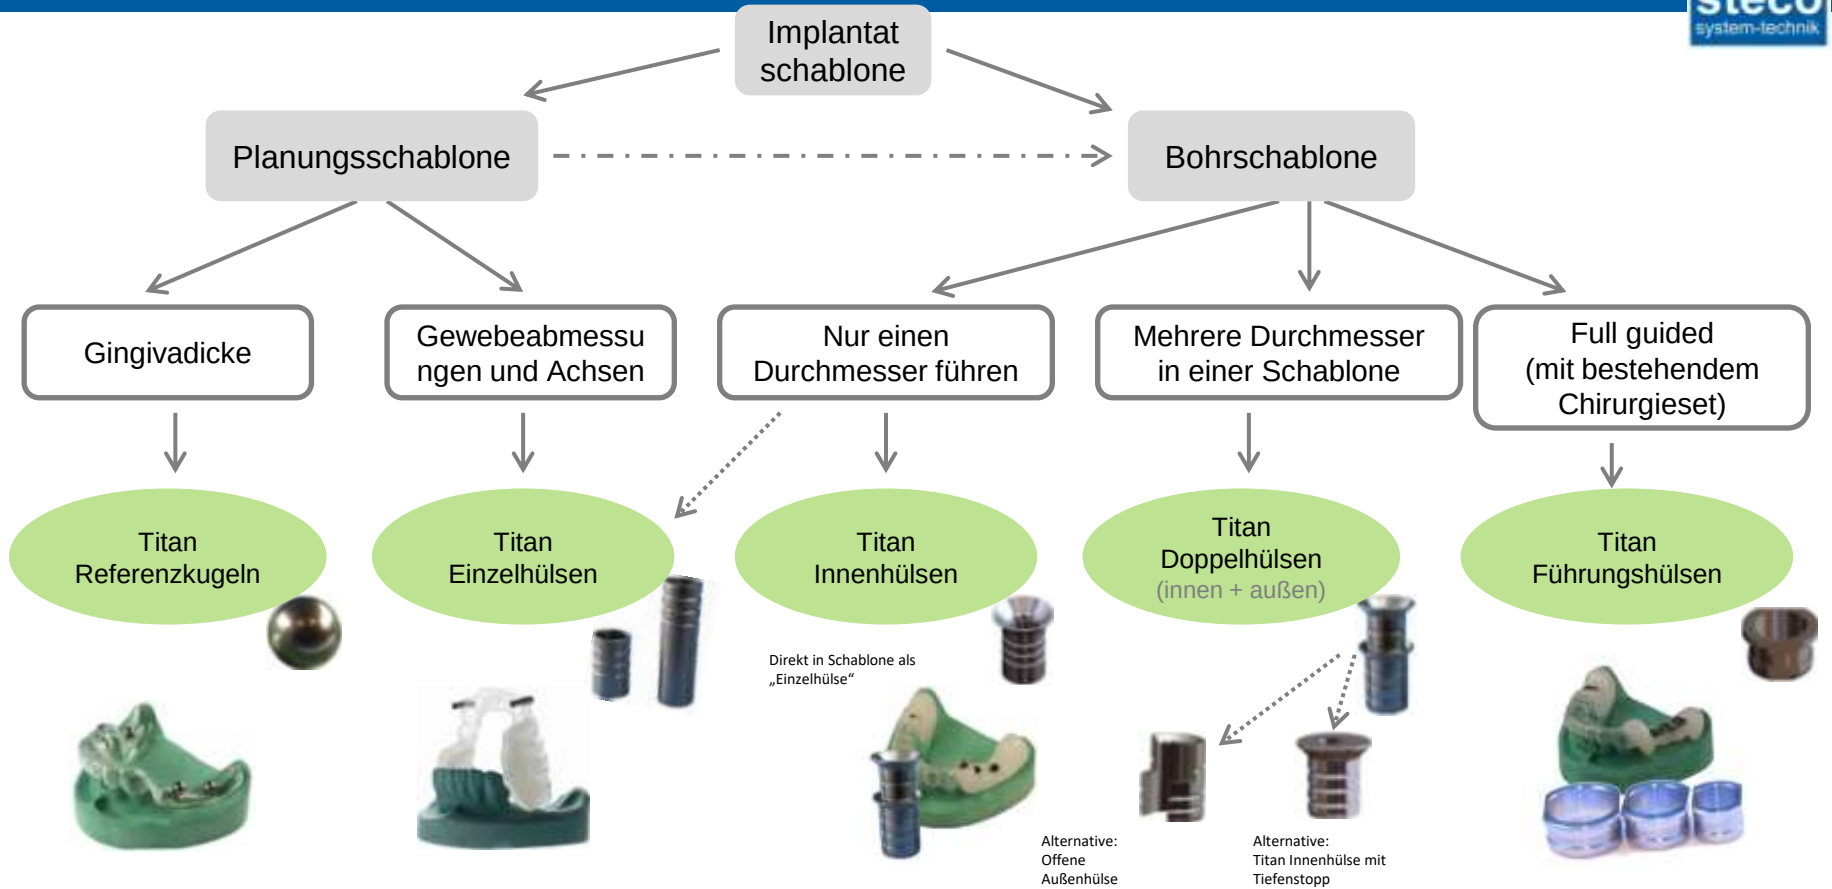

StecoGuide Einzelhülsen

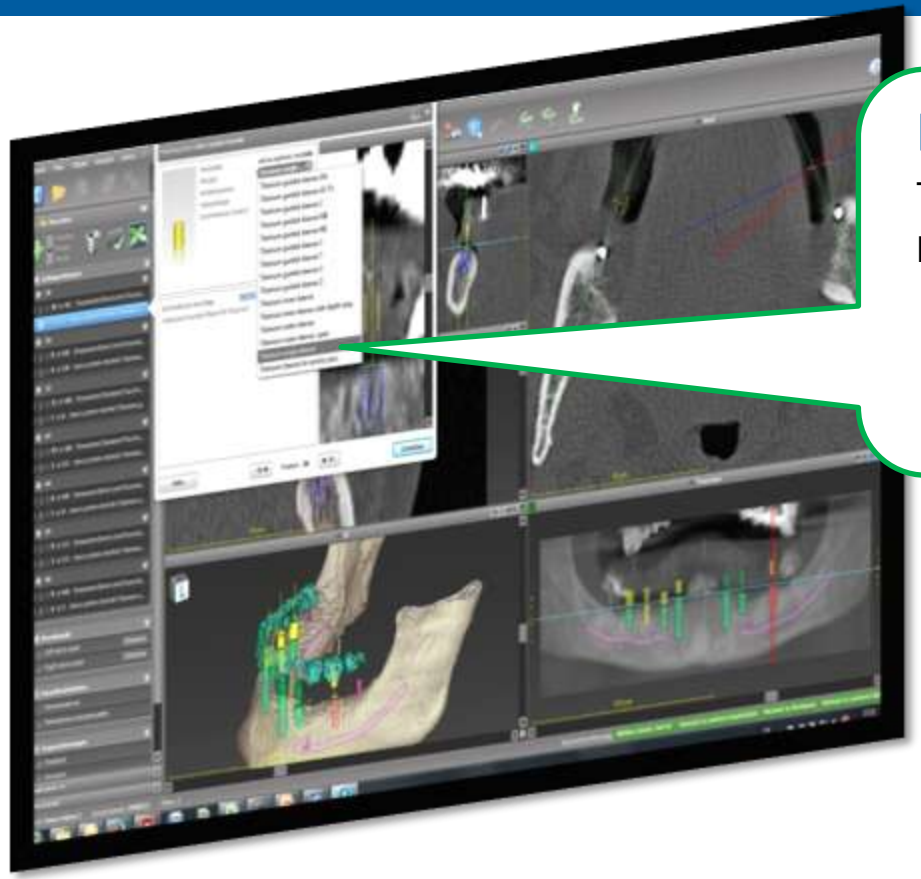

Einzelhülsen

Titan, zylindrisch, Planung, Diagnostik

Einfache Bohrschablone

- Länge 5 mm oder 10 mm
- Ø außen 3.0 mm
- Ø innen 2.35 oder 2,0 mm

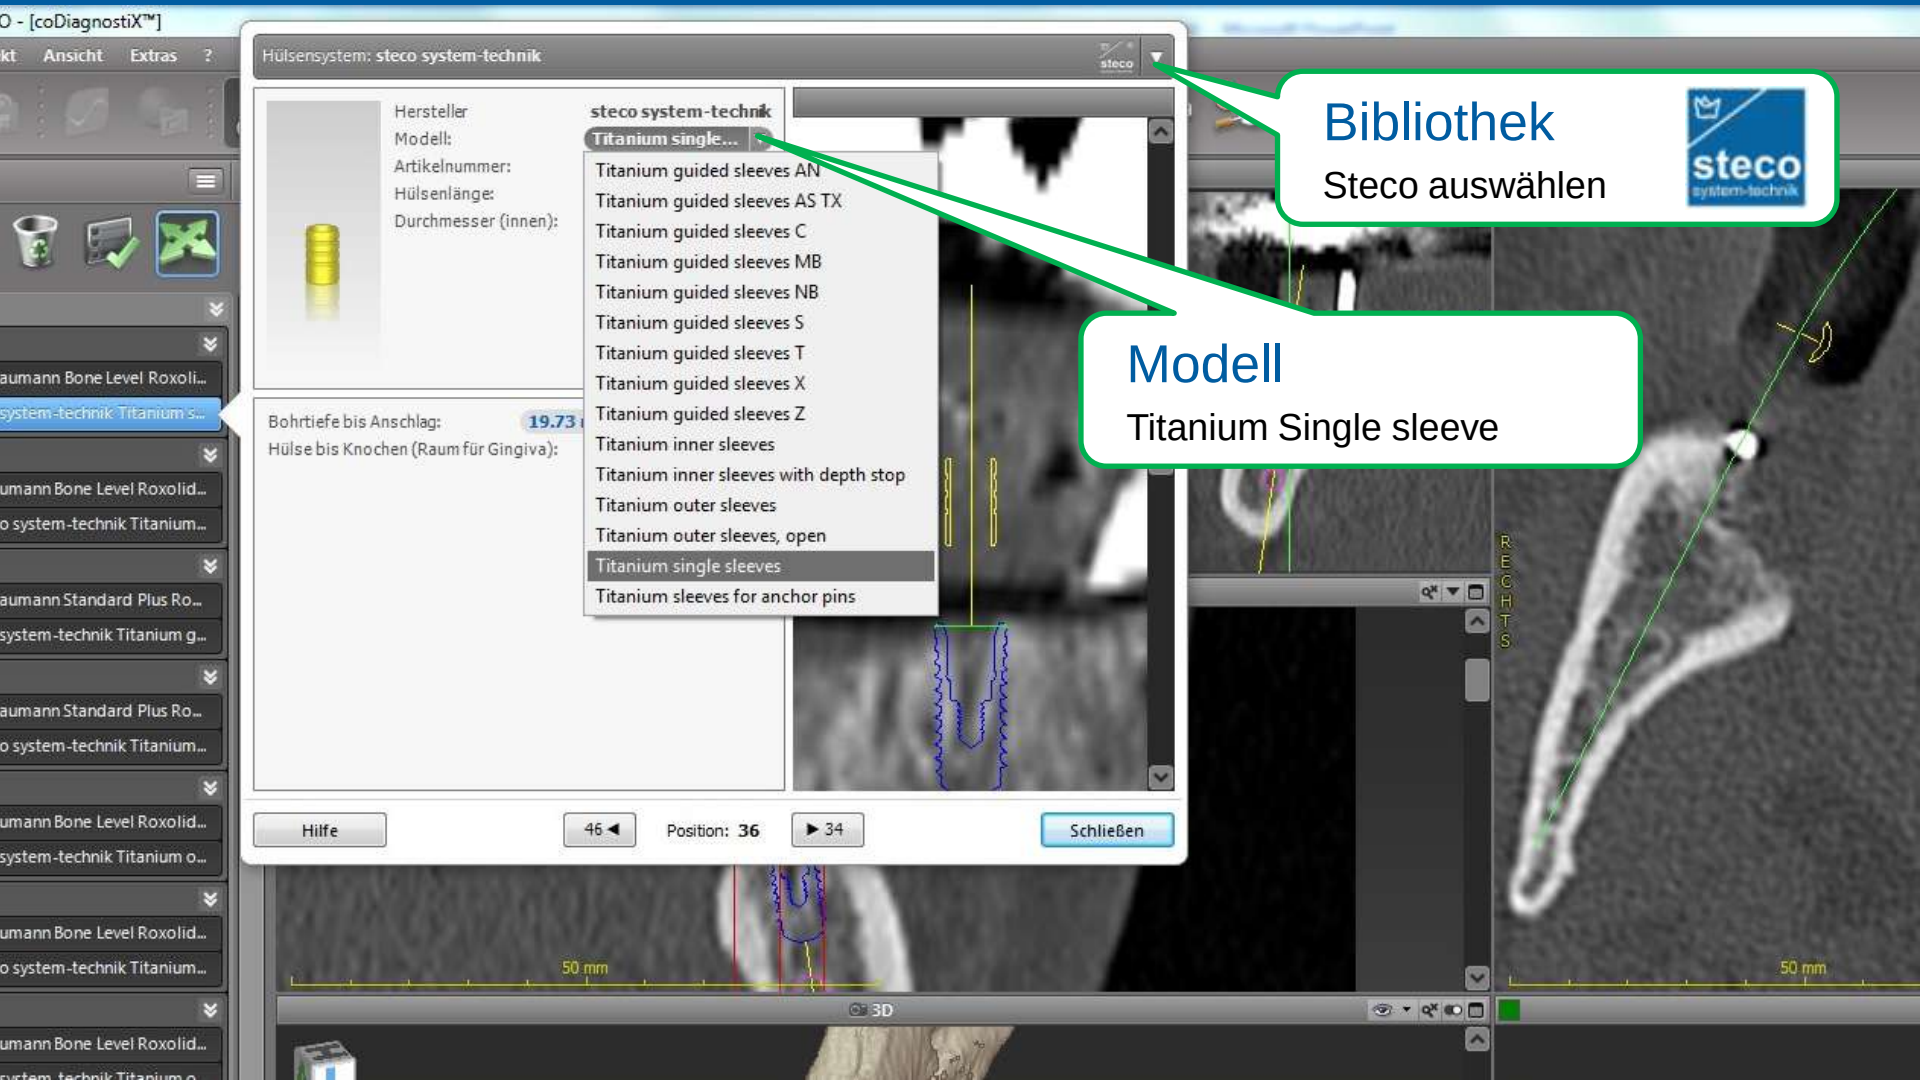
Hülsensystem: steco system-technik
Hersteller
steco system-technik
Modell:
Titanium single...
Artikelnummer:
Hülsenlänge:
Durchmesser (innen):
Titanium guided sleeves AN
Titanium guided sleeves AS TX
Titanium guided sleeves C
Titanium guided sleeves MB
Titanium guided sleeves NB
Titanium guided sleeves S
Titanium guided sleeves T
Titanium guided sleeves X
Titanium guided sleeves Z
Titanium inner sleeves
Titanium inner sleeves with depth stop
Titanium outer sleeves
Titanium outer sleeves, open
Titanium single sleeves
Titanium sleeves for anchor pins
Bohrtiefe bis Anschlag:
19.73
Hülse bis Knochen (Raum für Gingiva):
Hilfe
46
Position: 36
34
Schließen
Bibliothek
Steco auswählen
Modell
Titanium Single sleeve
50 mm
3D

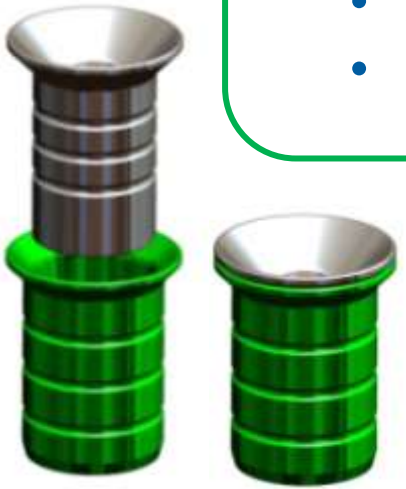

Bohrschablonen mit Doppelhülsen

Verschiedene Durchmesser
in einer Schablone führen

- Außenhülse in Schablone fixiert
- Innenhülse wird eingesteckt

universelle Hülsen

- Außenhülsen geschlossen und offen
- Innenhülsen mit Trichter oder Tiefenanschlag

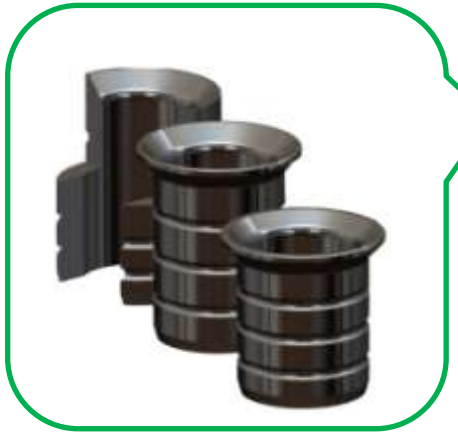

Außenhülsen
–5 und 6 mm Länge
–Außen Ø 4.0 mm
–Innen Ø 3.5 mm

Innenhülsen
–5 oder 6 bzw. 10 mm Länge
–Außen Ø 3.5 mm
–Innen Ø 1.6, 2.0, 2.2, 2.35, 2.5, 2.8 mm
–Innen Ø 1.0, 1.16, 1.3, 2.0, 2.2, 2.35 mm

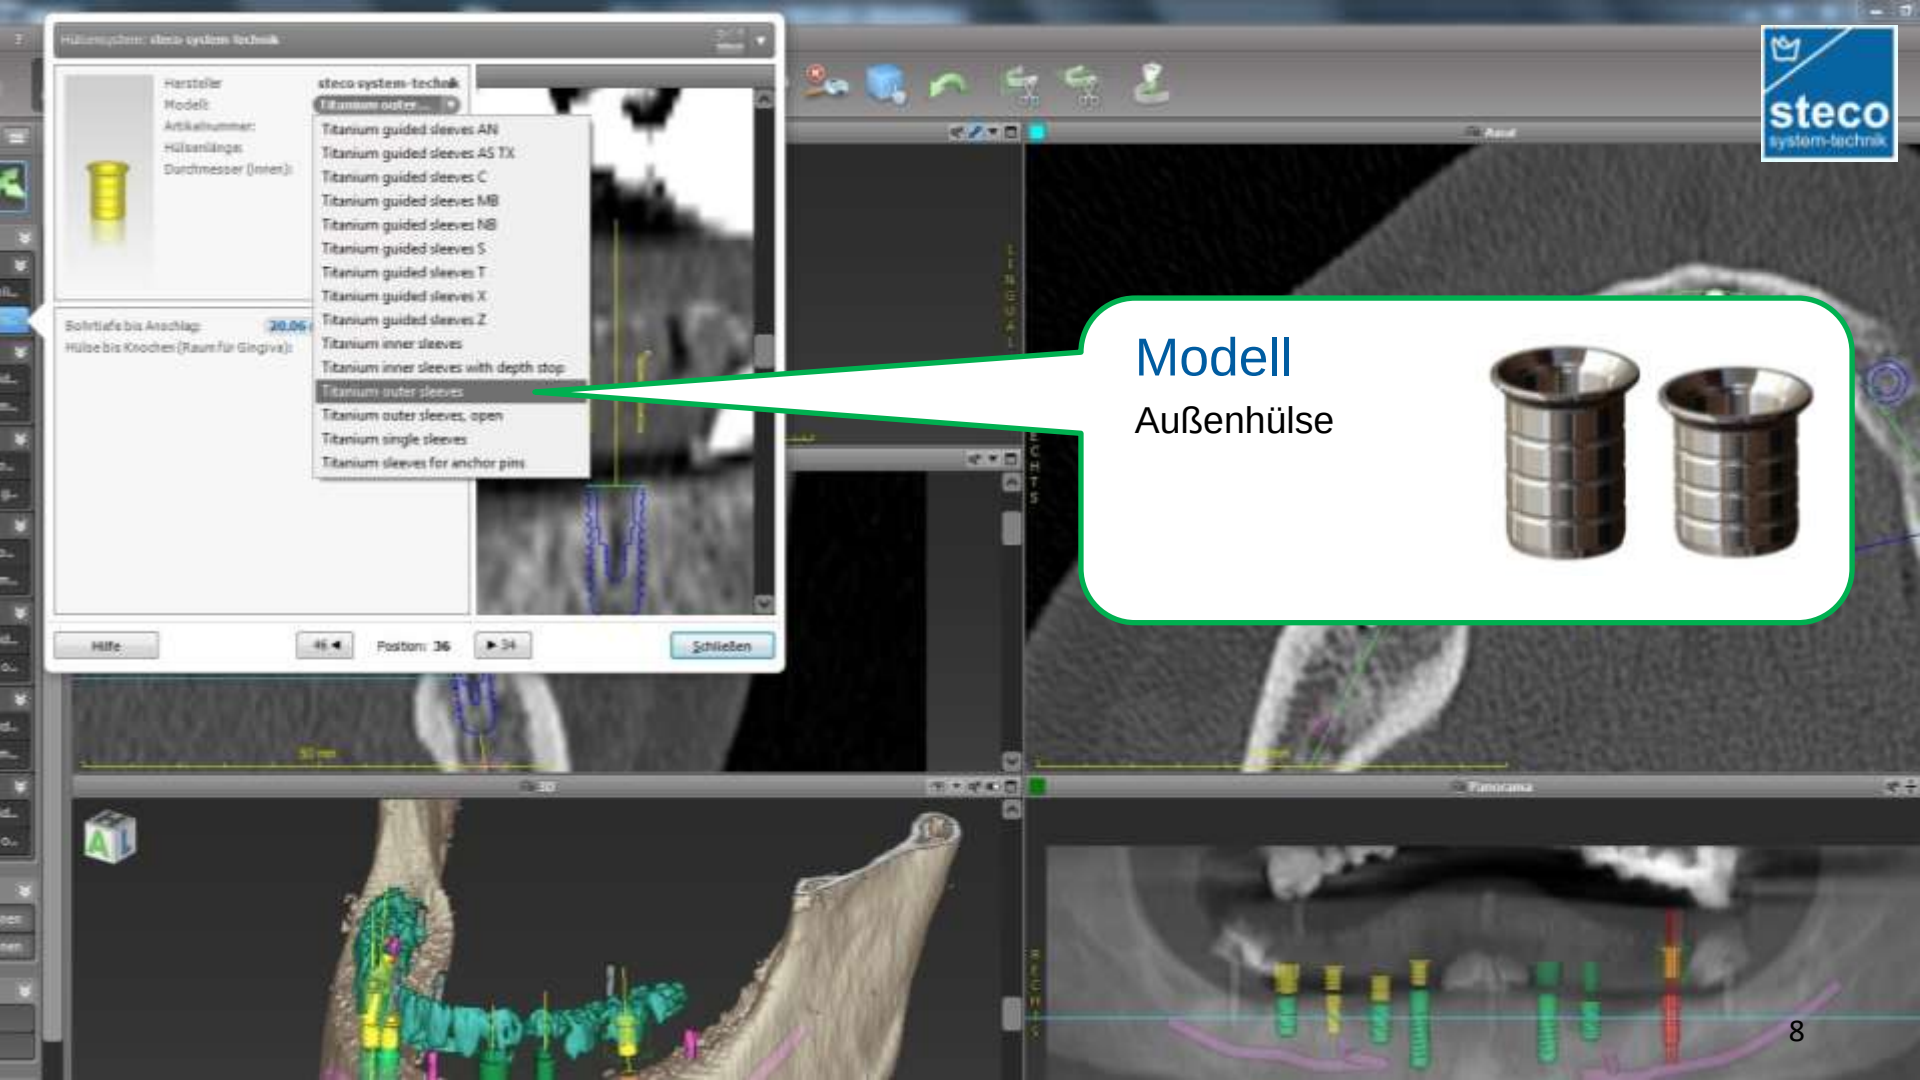
Hersteller
Modell
Artikelnummer:
Hülsenlänge:
Durchmesser (Innen):
steco system-technik
Titanium guided sleeves AN
Titanium guided sleeves AS TX
Titanium guided sleeves C
Titanium guided sleeves MB
Titanium guided sleeves NB
Titanium guided sleeves S
Titanium guided sleeves T
Titanium guided sleeves X
Titanium guided sleeves Z
Titanium inner sleeves
Titanium inner sleeves with depth stop
Titanium outer sleeves
Titanium outer sleeves, open
Titanium single sleeves
Titanium sleeves for anchor pins
Bohrtiefe bis Anschlag:
Hülse bis Knochen (Raum für Gingiva):
Hilfe
Position: 36
Schließen
Modell
Außenhülse
steco
system-technik

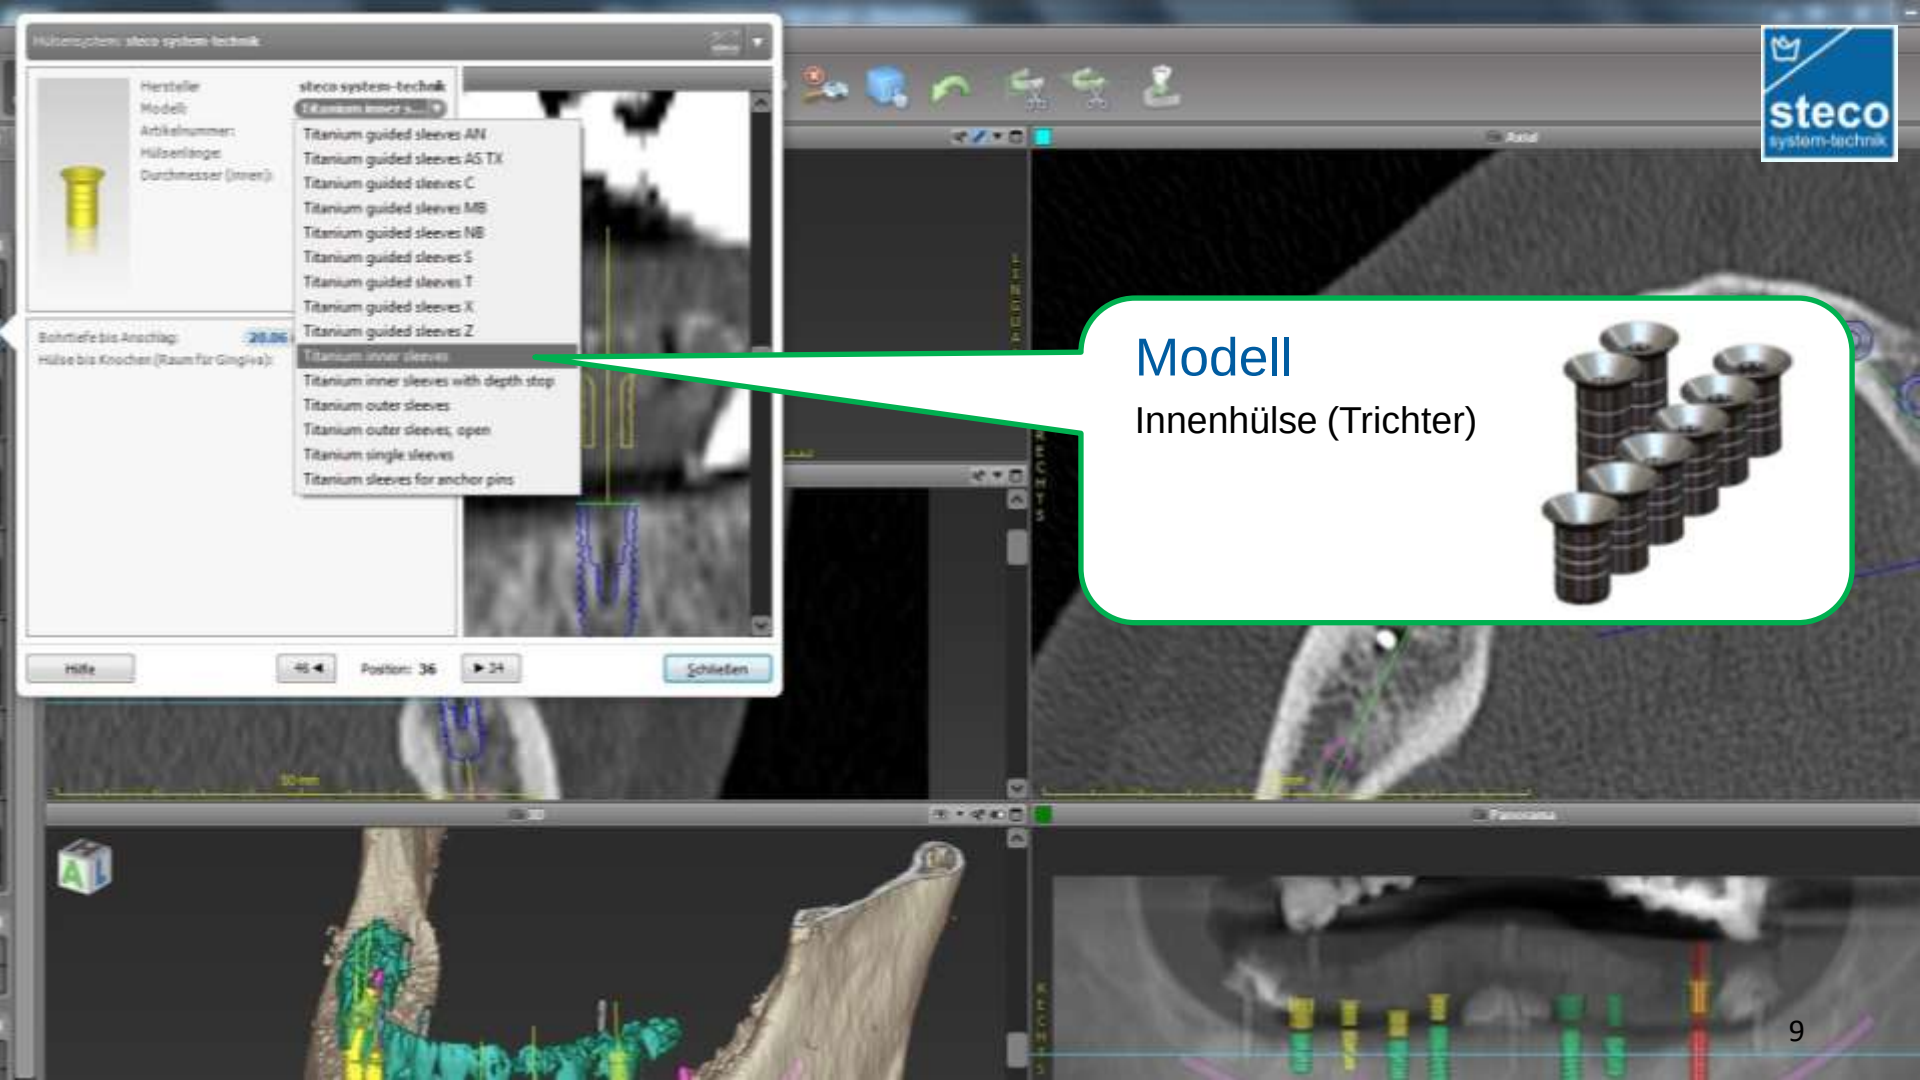
Hülsensystem: steco system-technik
Hersteller
steco system-technik
Modell:
Artikelnummer:
Hülsenlänge:
Durchmesser (innen):
Titanium guided sleeves AN
Titanium guided sleeves AS TX
Titanium guided sleeves C
Titanium guided sleeves MB
Titanium guided sleeves NB
Titanium guided sleeves S
Titanium guided sleeves T
Titanium guided sleeves X
Titanium guided sleeves Z
Titanium inner sleeves
Titanium inner sleeves with depth stop
Titanium outer sleeves
Titanium outer sleeves, open
Titanium single sleeves
Titanium sleeves for anchor pins
Bohrtiefe bis Anschlag:
Hülse bis Knochen (Raum für Gingiva):
Hilfe
Position: 36
Schließen
Modell
Innenhülse (Trichter)
steco
system-technik

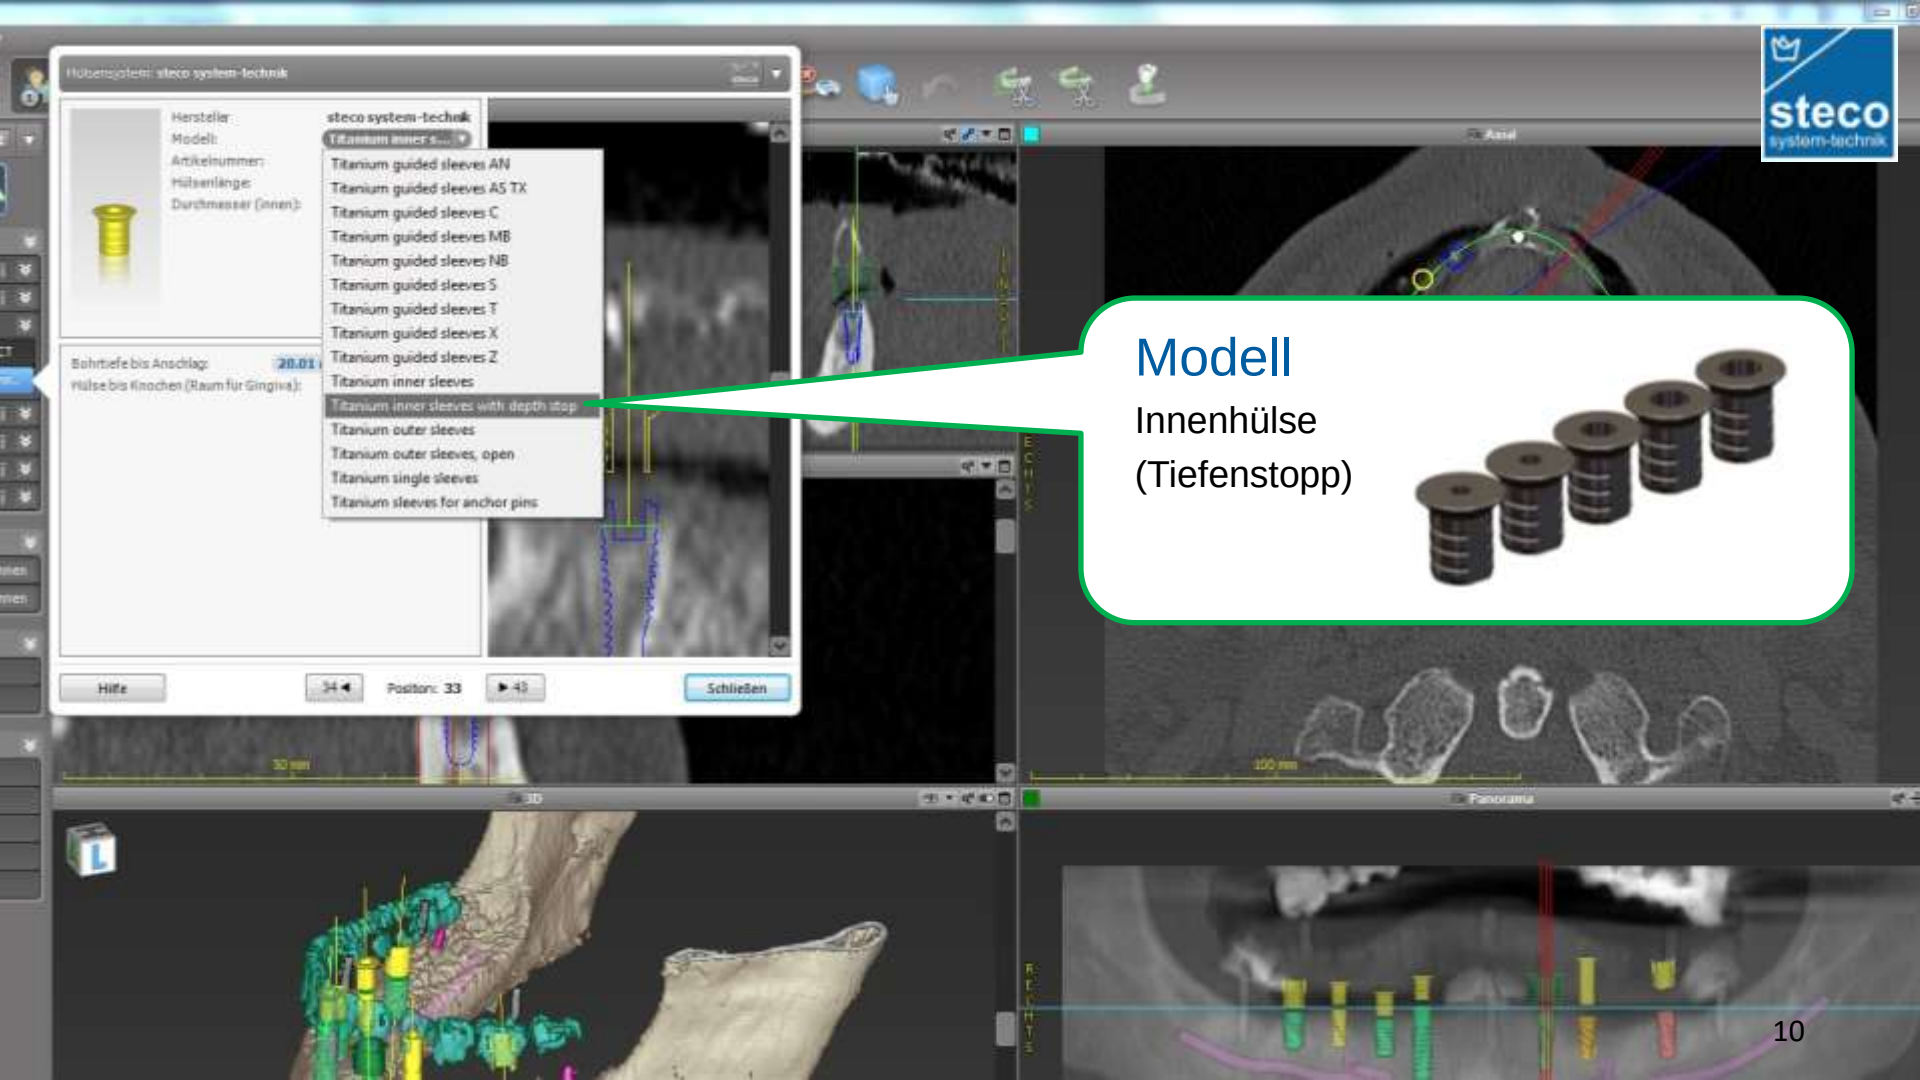
Hülsensystem: steco system-technik
Hersteller:
steco system-technik
Modell:
Artikelnummer:
Hülsenlänge:
Durchmesser (innen):
Titanium guided sleeves AN
Titanium guided sleeves A5 TX
Titanium guided sleeves C
Titanium guided sleeves MB
Titanium guided sleeves NB
Titanium guided sleeves S
Titanium guided sleeves T
Titanium guided sleeves X
Titanium guided sleeves Z
Titanium inner sleeves
Titanium inner sleeves with depth stop
Titanium outer sleeves
Titanium outer sleeves, open
Titanium single sleeves
Titanium sleeves for anchor pins
Bohrtiefe bis Anschlag:
Hülse bis Knochen (Raum für Gingiva):
Hilfe
Position: 33
Schließen
Axial
3D
Panorama
Modell
Innenhülse
(Tiefenstopp)
steco
system-technik

Tiefenstopp

Innenhülse sitzt auf Außenhülse

Titan-Außenhülse

geschlitzt D5/d3,5/L6

Seitliches Einschwenken

von Bohrer mit Innenhülse

Doppelhülsensystem für Thommen Medical

- Außenhülse (M.27.25.D350)
- Zwei Innenhülsen

  (M.27.25.D200L6, M.27.25.D280L6)

Nicht kompatibel mit universellen Doppelhülsen

Tiefenstopp

Über Lasermarkierung auf VECTOdrill

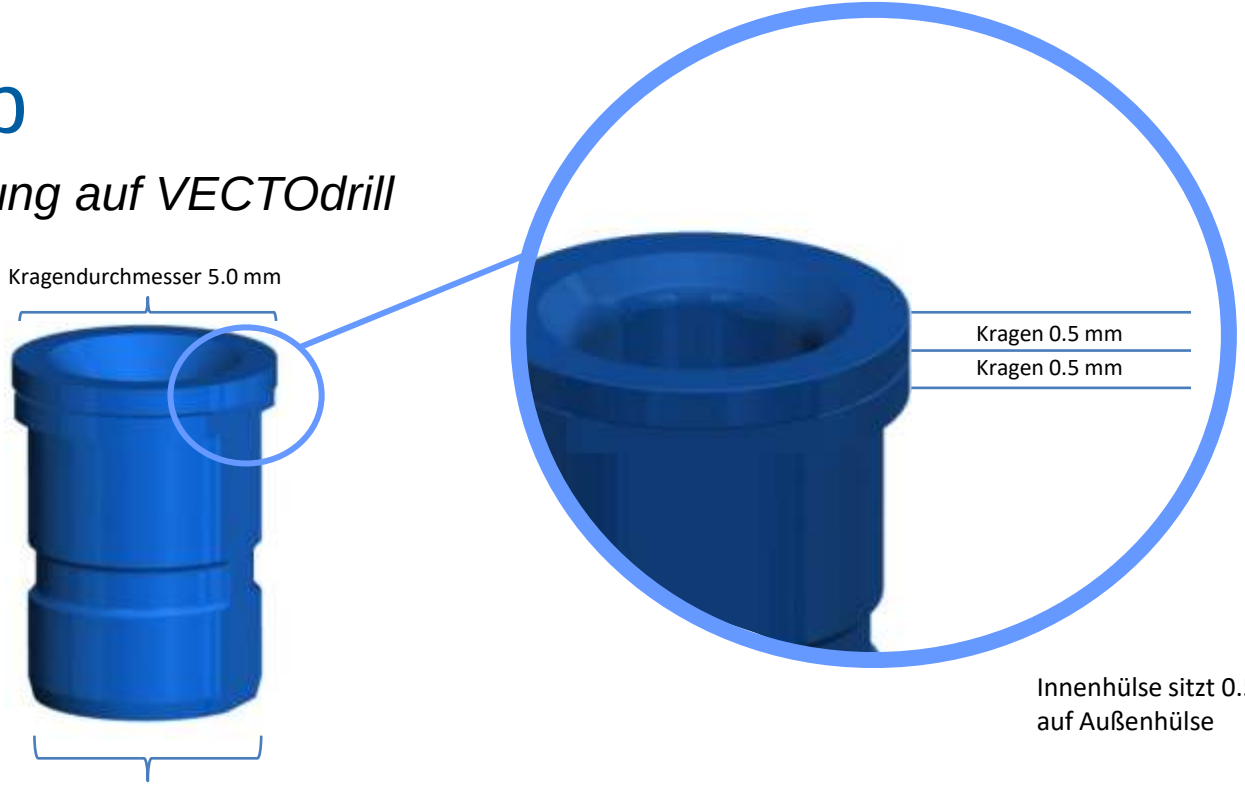

Führungshülsen

Alternative Hülsen für voll navigierte Chirurgie

Führungshülsen

Durchmesser und Länge wie von Original Hersteller

NobelGuide™

Nobel Biocare

straumann

camlog

DENTSPLY IMPLANTS

ANKYLOS

XiVE

ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM TX und ASTRA EV

mis

zimmer

BIOMET 3i
Compatible D420 D520

sweden&martina

BIOHORIZONS

Kompatibilität auch zu Systemen wie Neoss, implant direct …

Die genannten Marken gehören den jeweiligen Firmen

StecoGuide

Durchmesser wie Original

Seitlich abgeflacht

Titan anstatt Stahl

Länge wie Original

StecoGuide über Menü Bohrhülsen auswählen

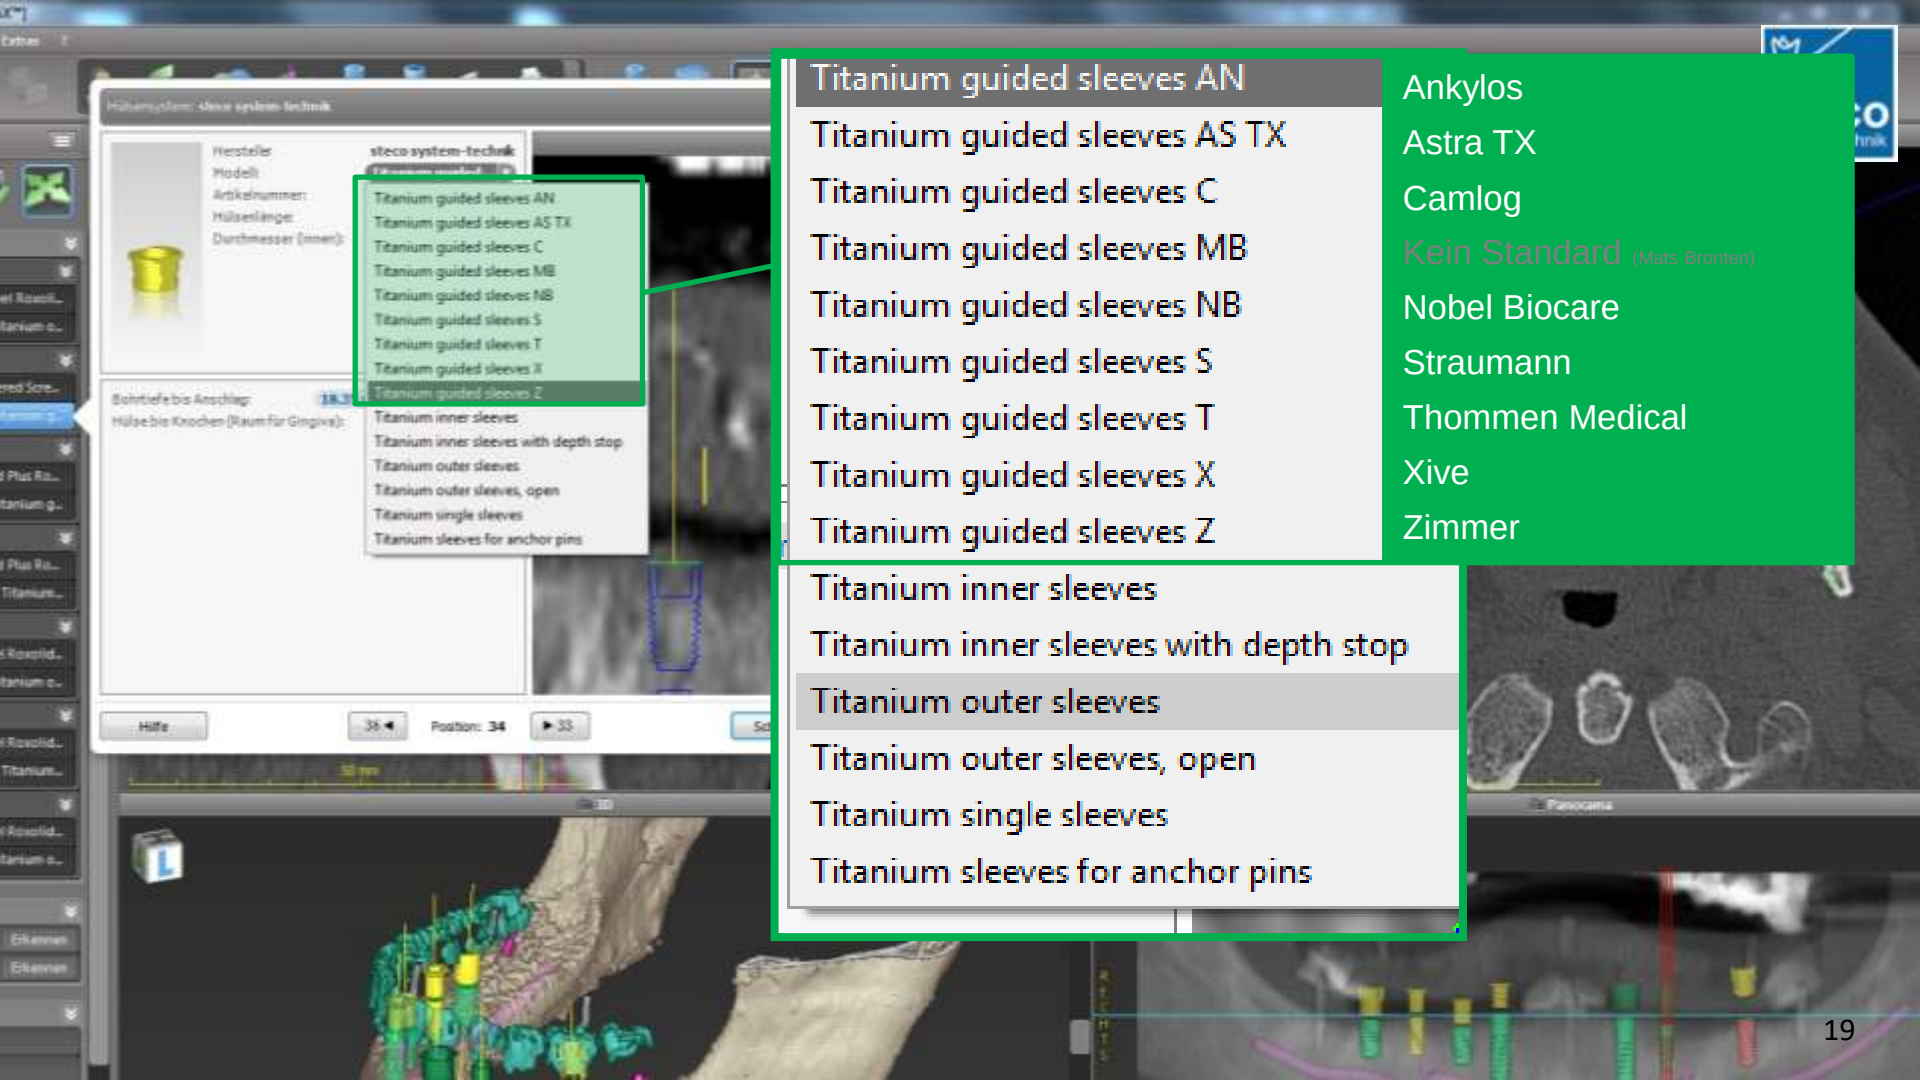
Titanium guided sleeves AN
Titanium guided sleeves AS TX
Titanium guided sleeves C
Titanium guided sleeves MB
Titanium guided sleeves NB
Titanium guided sleeves S
Titanium guided sleeves T
Titanium guided sleeves X
Titanium guided sleeves Z
Titanium inner sleeves
Titanium inner sleeves with depth stop
Titanium outer sleeves
Titanium outer sleeves, open
Titanium single sleeves
Titanium sleeves for anchor pins
Ankylos
Astra TX
Camlog
Kein Standard (Mats Bronten)
Nobel Biocare
Straumann
Thommen Medical
Xive
Zimmer

coDiagnostiX

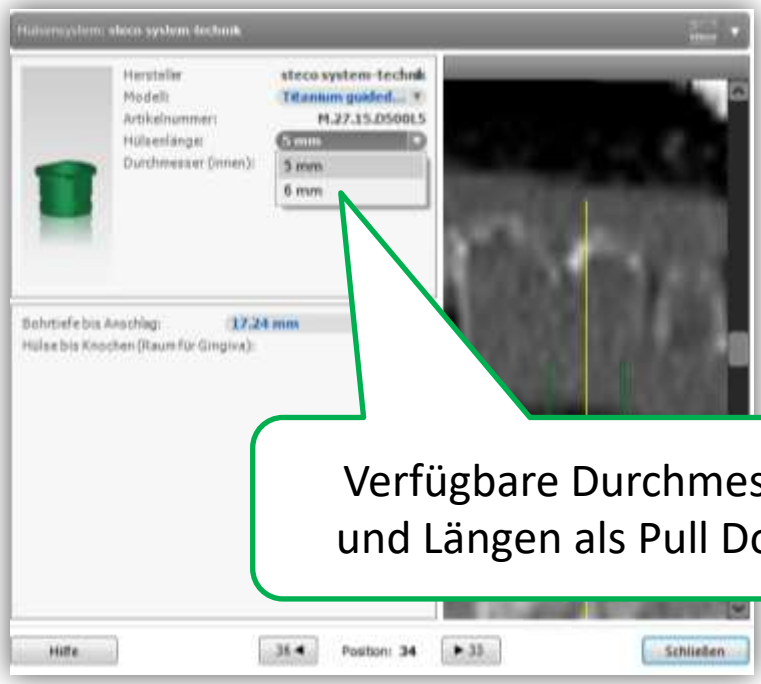

Verfügbare Durchmesser und Längen als Pull Down

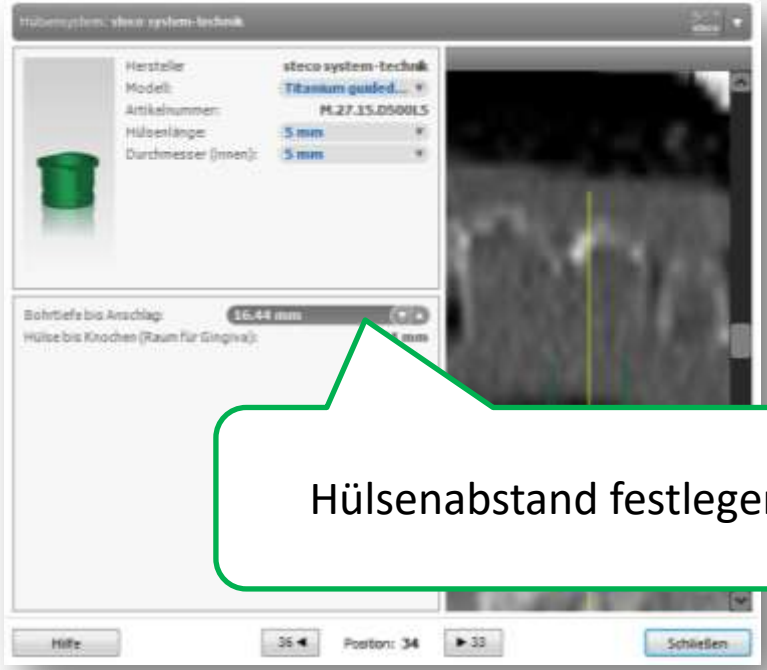

Hülsenabstand festlegen

Hülsen für Ankerpin

- M.27.20.D150L10
  für Nobel Guide Pins

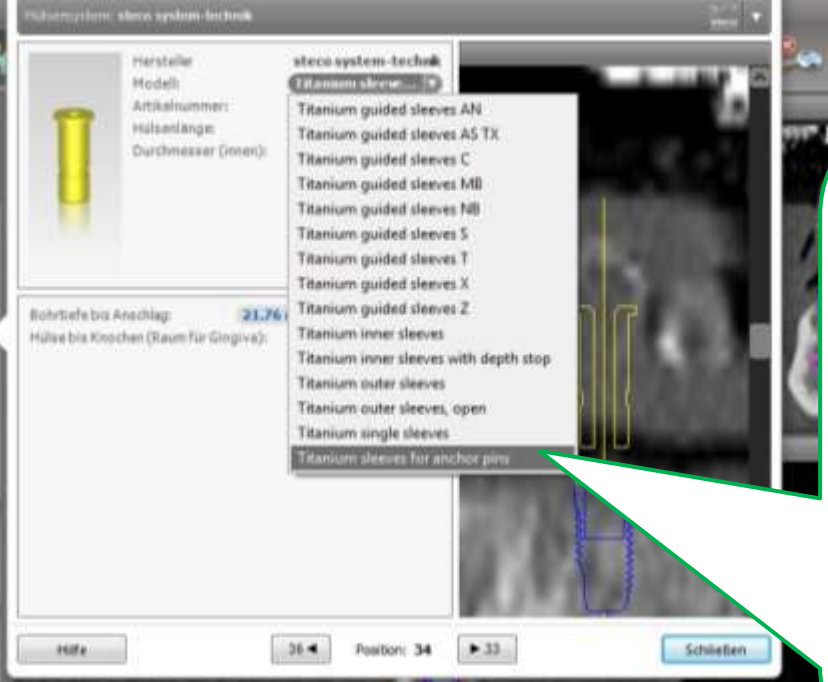

Kontakt

@ info@steco.de

☎ +49 (0)40 55 77 81 0

🖷 +49 (0)40 55 77 81 99

steco.beratung2

Finde uns auf Facebook

Kollaustr. 6 , 22529 Hamburg , Germany

www.steco.de